hb ar comprimido

A PRIMEIRA COM CERTIFICADO DE TESTE DAS
CENTRAIS DE AR COMPRIMIDO RESPIRÁVEL

A **hb ar comprimido** é a primeira empresa fabricante de **Centrais de Ar Comprimido Respirável** testada de acordo com as condições indicadas na RDC 307/02 da **ANVISA**

Veja o certificado

hb soluções em ar comprimido eireli
Rua Francisco Pedro do Amaral, 314 • São Paulo • SP • Brasil • CEP 05334-110
Tel.: 55 (11) 3766-3977 • sac@hb-arcomprimido.com
www.hb-arcomprimido.com

LINK TECNO

CERTIFICADO DE TESTE

Skid Ar Respirável Medicinal (CARM0010XX)

hb ar comprimido

AS MEDIÇÕES DA QUALIDADE DO AR RESPIRÁVEL FORAM EFETUADAS EM DOIS PONTOS, CONFORME FIGURA AO LADO, GRIFADOS EM AMARELO:

1. APÓS O SECADOR

2. NA SAÍDA DO AR RESPIRÁVEL

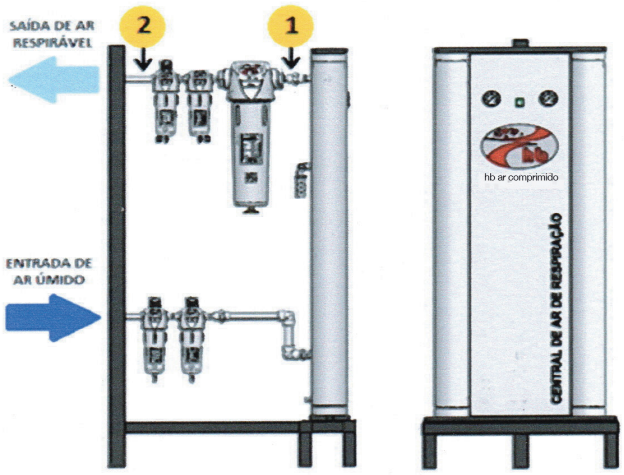

RESULTADOS OBTIDOS:

Analito	Método	RDC 307/02	PONTO 1	PONTO 2
Oxigênio (% v/v)	Cromatografia gasosa	20,4 a 21,4	-	21,19
Monóxido de Carbono (ppm)	Cromatografia gasosa	5,0 (máx)	< 2	< 2
Dióxido de Carbono (ppm)	Cromatografia gasosa	500 (máx)	363	460
Óxido e Dióxido de Nitrogênio (ppm)	Cromatografia de íons	2,0 (máx)	-	< 0,12
Dióxido de Enxofre (ppm)	Cromatografia de íons	1,0 (máx)	-	0,008
Teor de óleo (mg/m3)	Espectrofotometria no infravermelho	0,1 (máx)	-	< 0,04
Teor de particulados (mg/m3)	Gravimetria	0,1 (máx)	-	< 0,1
Temperatura de Ponto de Orvalho à pressão atmosférica (°C)	Medidor de temperatura de ponto de orvalho	- 45,5	- 47,1	- 45,5

Ref.:Laudo Link Tecno n° RQ-197-18 Revisão 00 - 30/04/2019

CONCLUSÃO:

Skid aprovado nos testes de acordo com as condições indicadas na RDC 307/02 da ANVISA.

Elaborado LINK TECNO	Revisado e Aprovado LINK TECNO	Aprovado hb ar comprimido
Anderson Zukeran Arasato Técnico Eletrônico	Margarete Miyuke Nagata Gerente de Serviços	Waldemar Aguiar Lessa Jr. Coordenador de Engenharia